
Installationshinweise


Austausch-Elektrode

AmmoLyt® NHA/AT

für die Referenz-Elektrode AmmoLyt® NHA

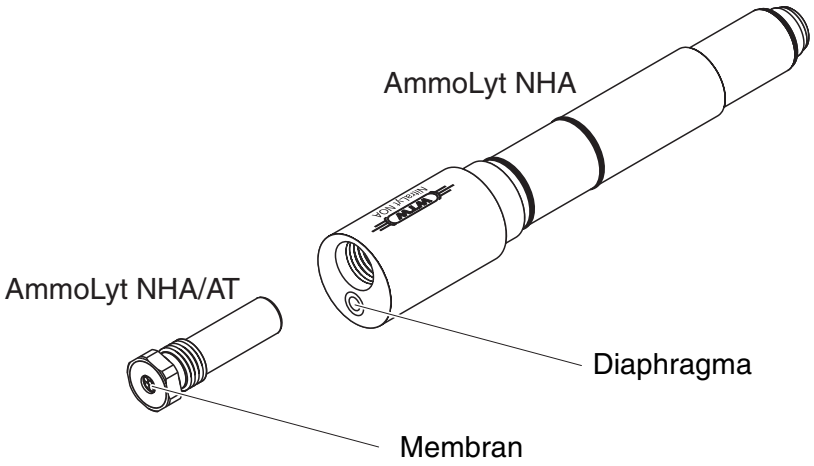


Austausch-Elektrode AmmoLyt® NHA/AT in die Referenz-Elektrode AmmoLyt® NHA einsetzen:

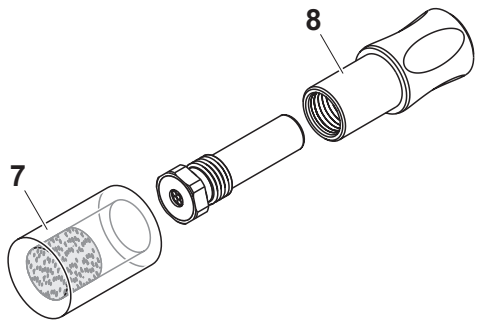

1	Die Wässerungskappe (1) und die Mutter (2) von der Austauschelektrode entfernen. Beide Hilfsmittel für eine eventuelle Lagerung der Elektrode aufbewahren.

2 Die Austauschelektrode AmmoLyt® NHA/AT spaltfrei in die Referenzelektrode AmmoLyt® NHA einschrauben.
Als Schraubenschlüssel ist ein Gabelschlüssel (Schlüsselweite 13 mm) oder der Sensor-Schutzkorb geeignet (siehe folgendes Bild).

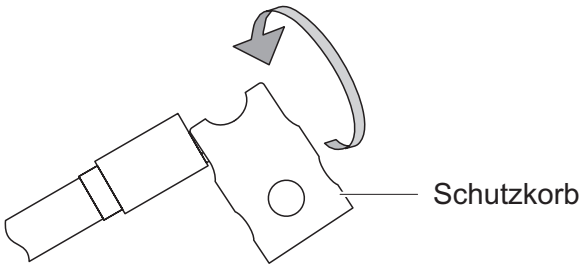

Vorsicht
Die Membran und das Diaphragma der Messkette
- **niemals eintrocknen lassen (Hinweise zur Lagerung beachten)**
- **nicht beschädigen**
- **nicht mit Fett in Kontakt bringen.**

Hinweis
Klopfen Sie nach dem Einbau der Elektrode mit dem Finger gegen die Messkette, um eventuell anhaftende Luftblasen von der Rückseite der Membran zu entfernen. Halten Sie die Messkette dabei senkrecht (Membran nach unten).

Reinigung

In eingebautem Zustand:
Elektrode AmmoLyt® NHA/AT mit Wasser abspritzen. Grobe Verunreinigungen unter fließendem Wasser mit einer weichen Zahnbürste entfernen.

Hinweis
Technische Daten der Messkette finden Sie in der Betriebsanleitung der Referenz-Elektrode AmmoLyt® NHA.

Hinweise zum Einbau der Messkette in den Sensor AmmoLyt® 700 IQ finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors AmmoLyt® 700 IQ.